




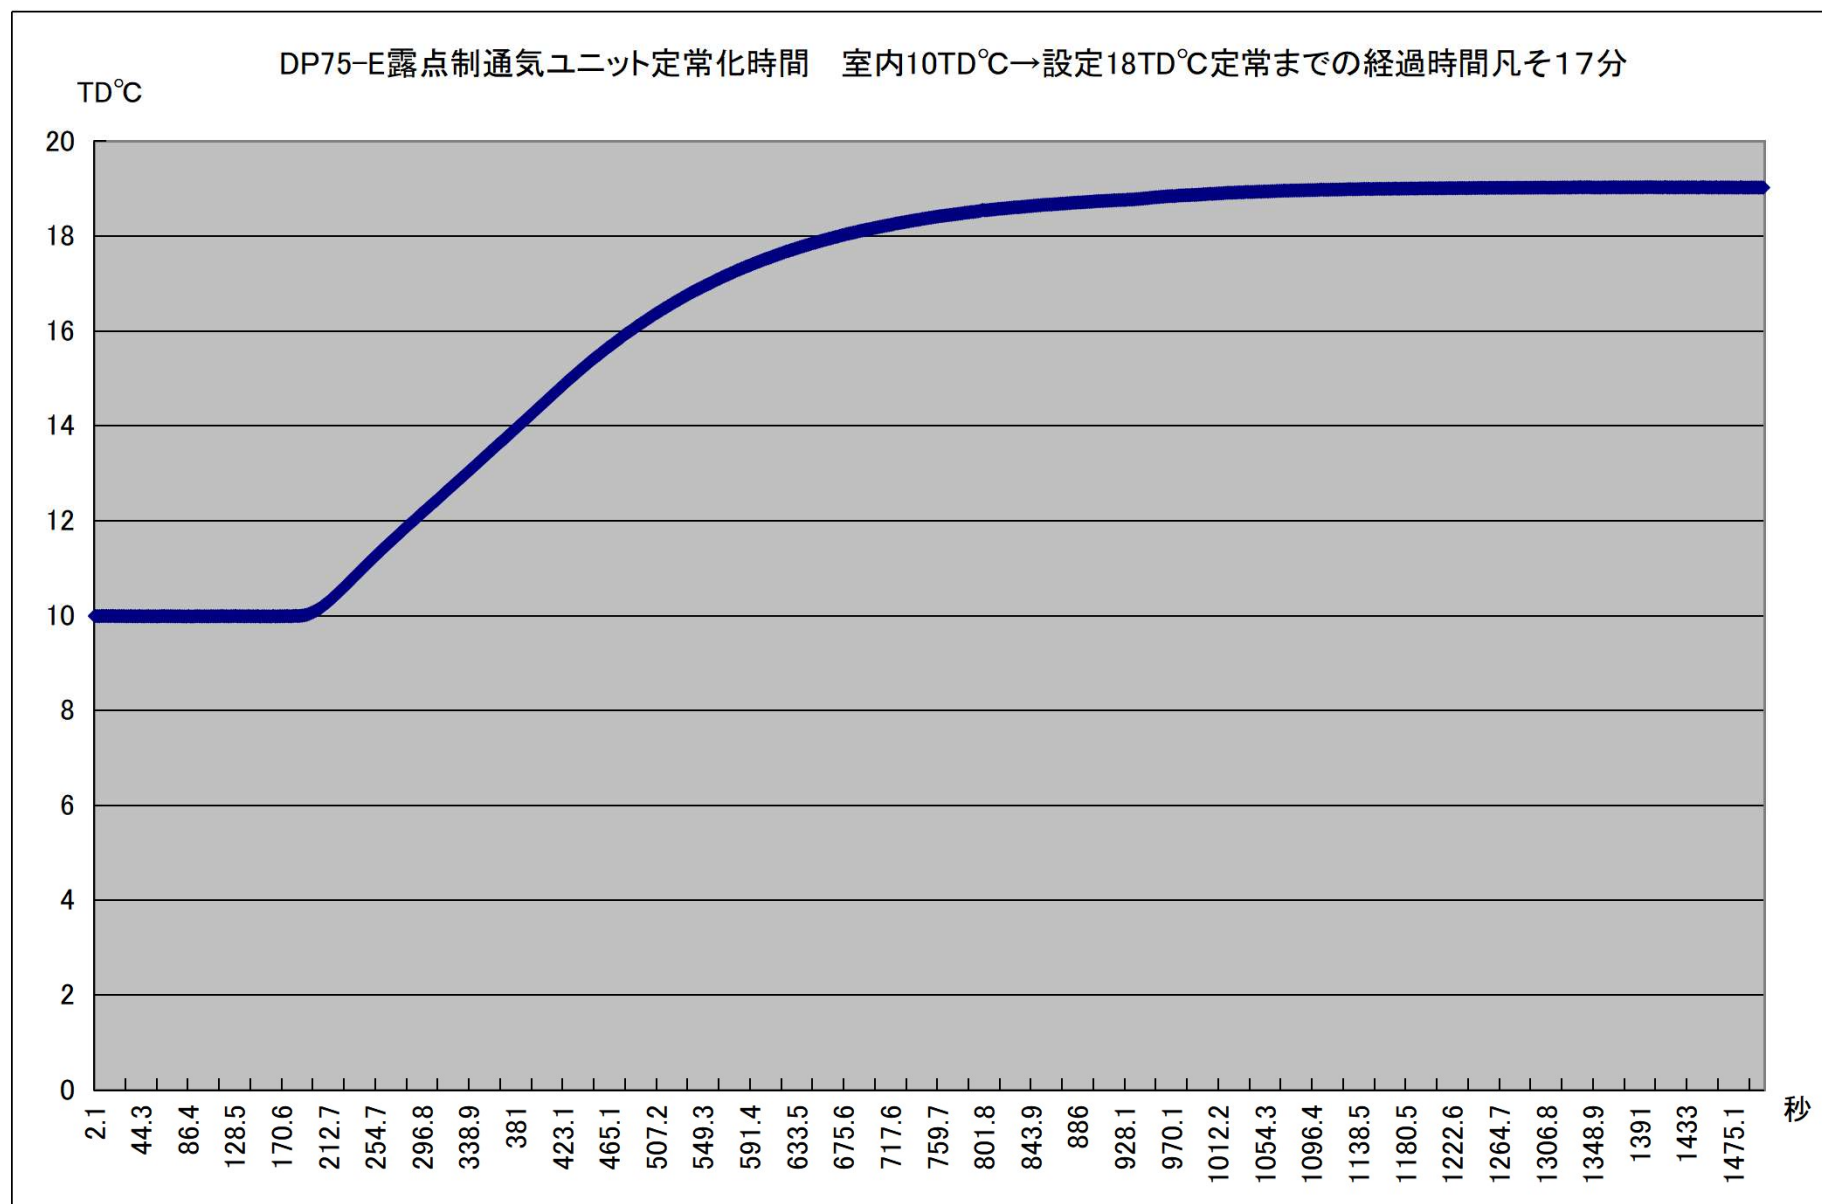

DP75-E露点制御通気ユニット設定17.3TD°CでのLI-6262分析計での長時間測定約50分

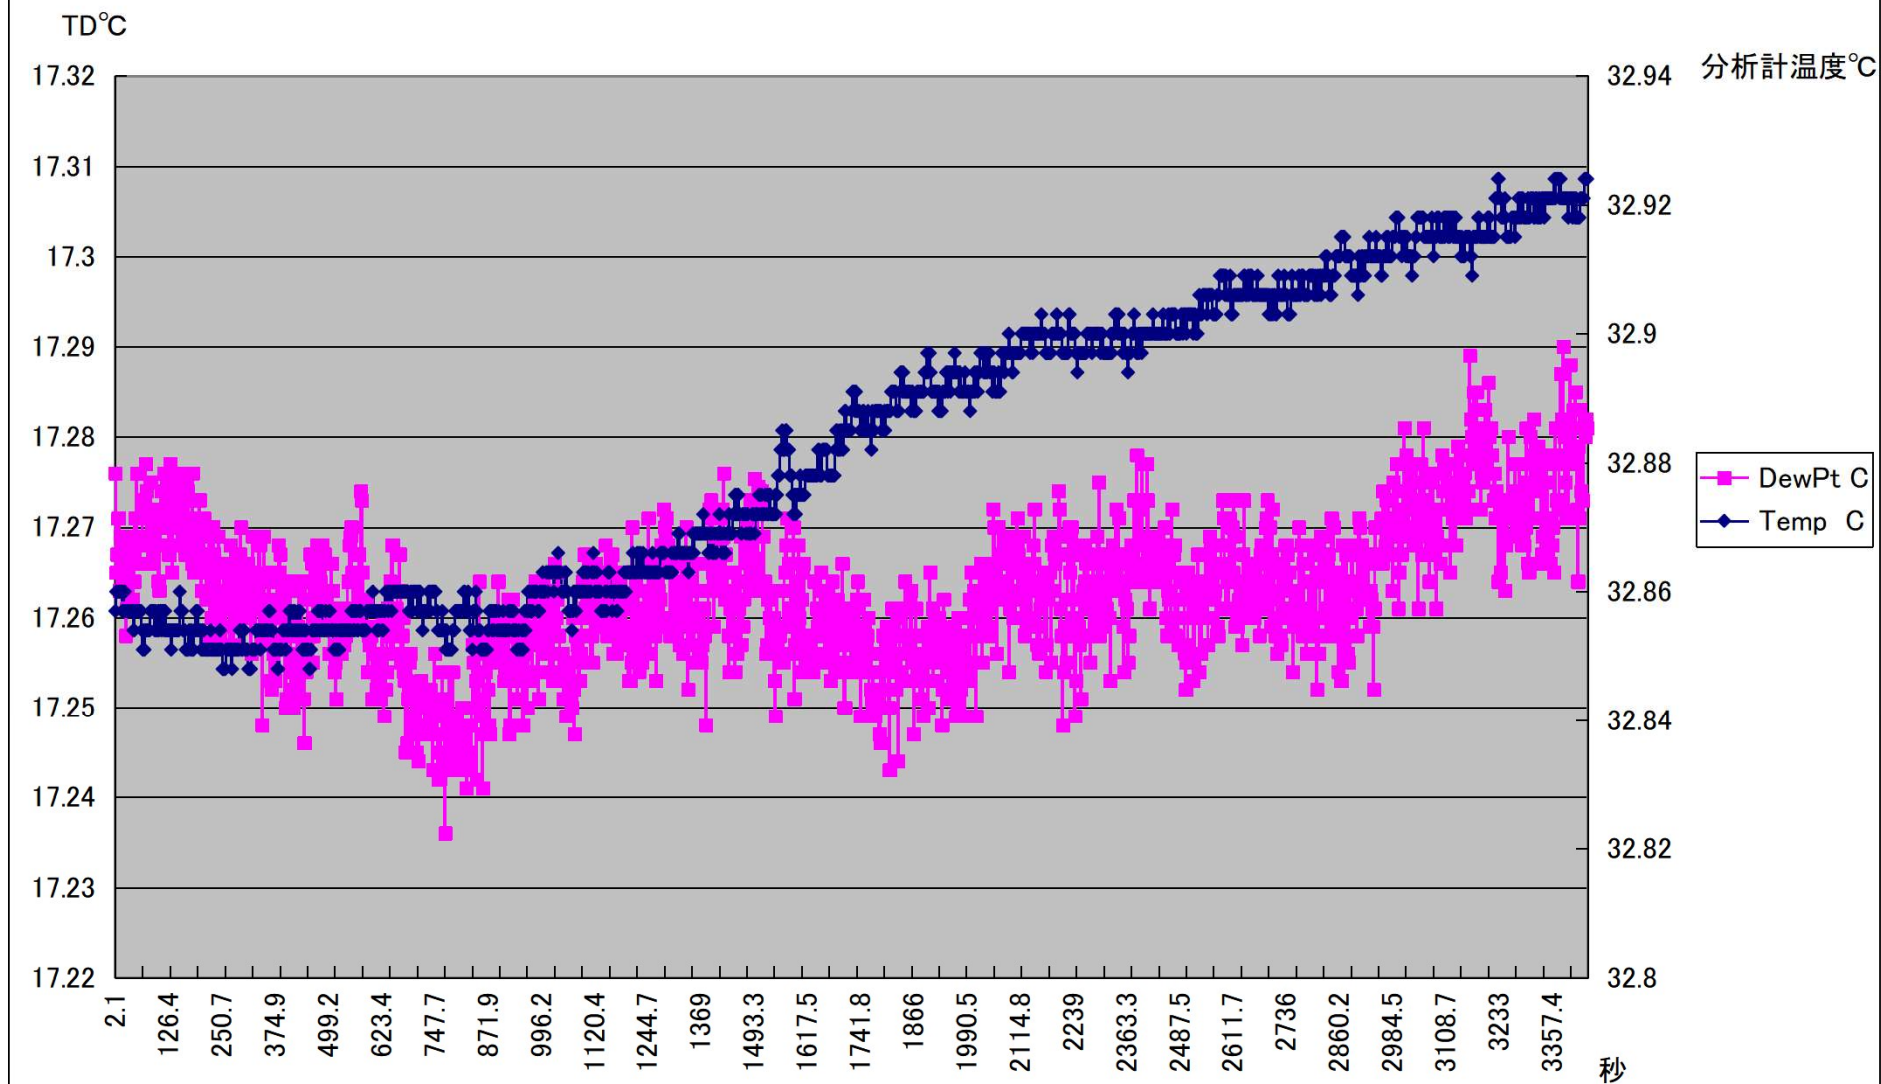

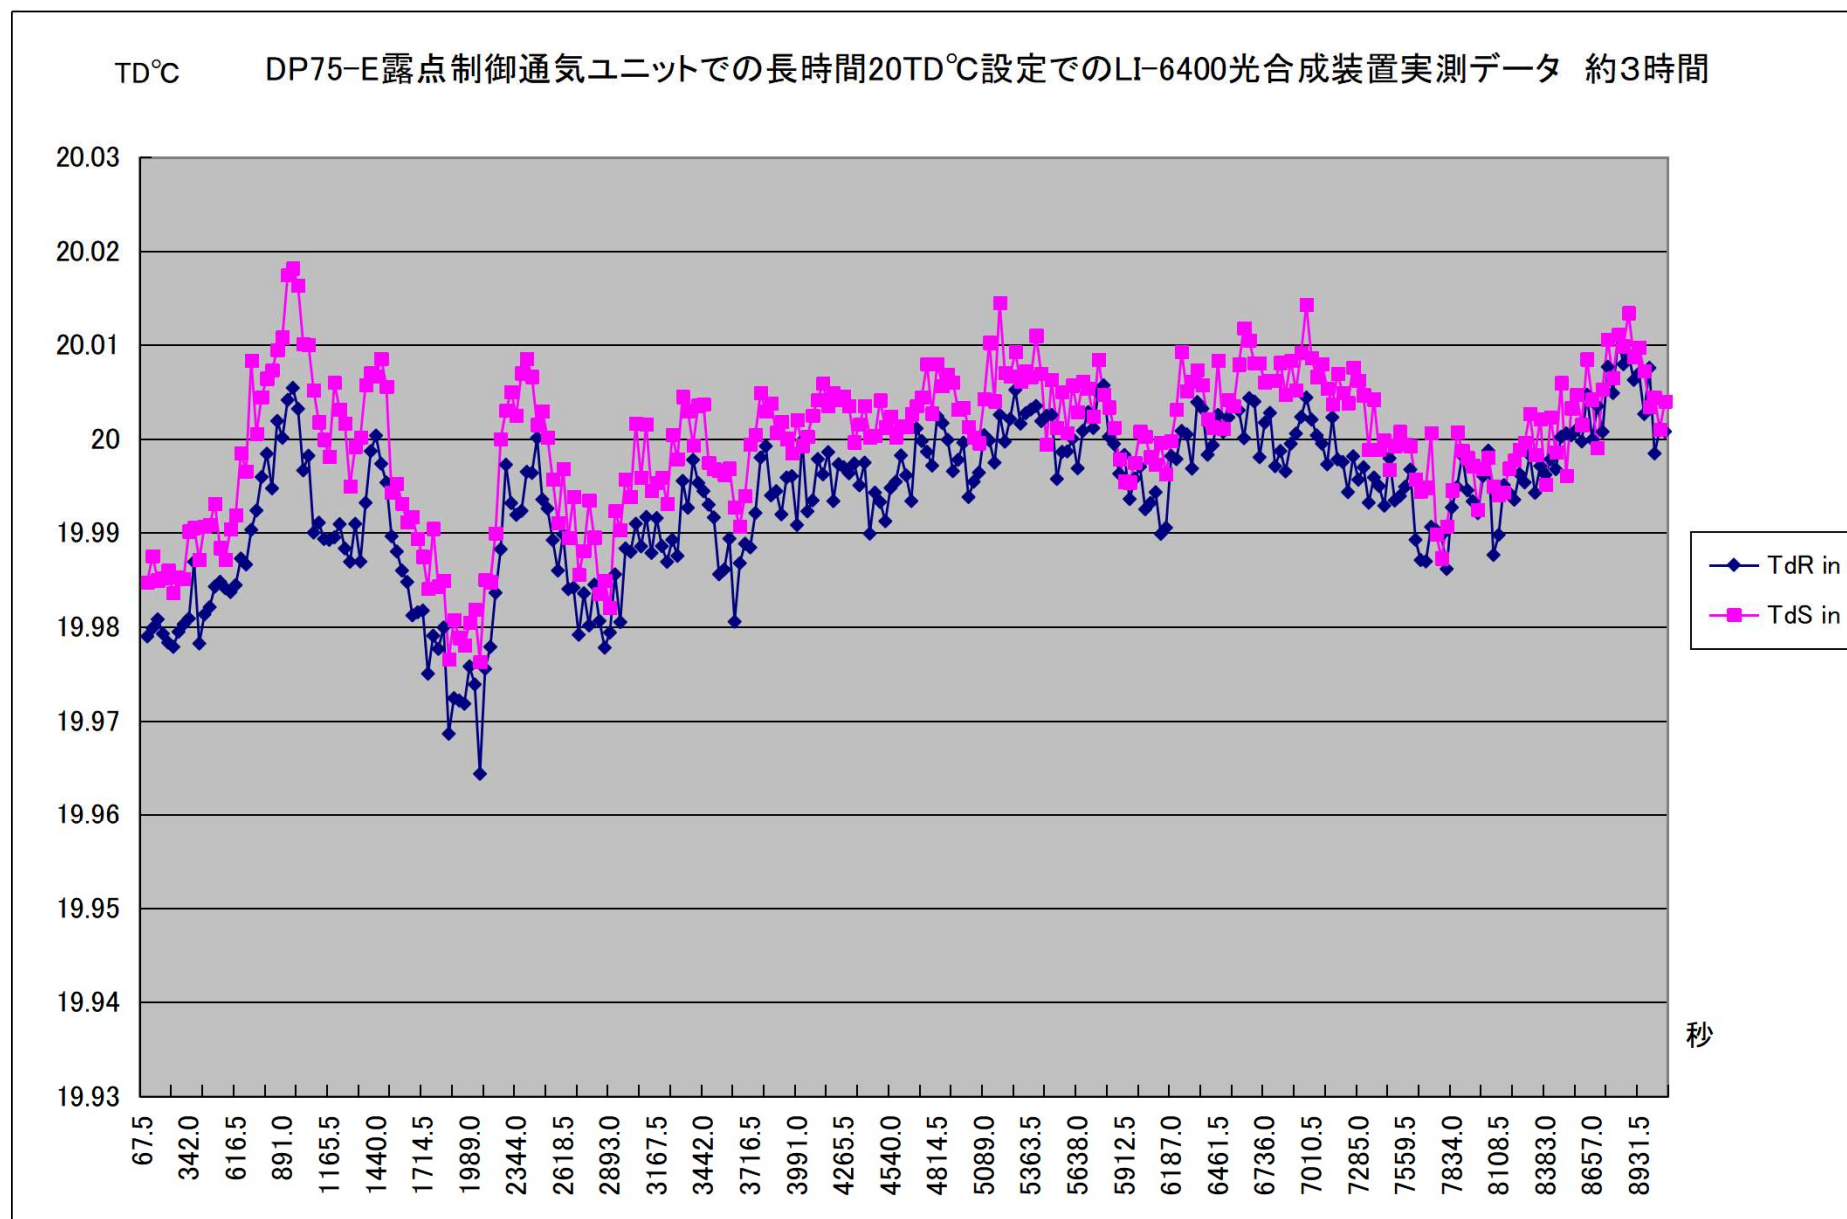

DP75-E 露点制御通気ユニットTD15. 0℃設定時のLI-6400TdSでの実測データ 約1時間

